

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «18» октября 2021 г. № 2303

Регистрационный № 83393-21

Лист № 1  
Всего листов 12

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Весы лабораторные электронные В

#### **Назначение средства измерений**

Весы лабораторные электронные В (далее - весы) предназначены для статического измерения массы.

#### **Описание средства измерений**

Принцип действия весов основан на преобразовании действующей на весы силовой нагрузки, создаваемой взвешиваемым объектом, в деформацию упругого элемента весоизмерительного датчика, на котором нанесены тензорезисторы. Деформация упругого элемента вызывает изменение электрического сопротивления тензорезисторов, преобразуемого в аналоговый электрический сигнал. Электрический сигнал, пропорциональный массе взвешиваемого объекта, поступает на вход вторичного преобразователя для обработки и индикации результатов измерений. Для снижения уровня помех в аналого-цифровом преобразователе (по заказу) применяется вибрационный (акустический) датчик.

Весы состоят из весоизмерительного устройства и индикатора. Весоизмерительное устройство включает в себя грузоприемное и грузопередающее устройства, весоизмерительный датчик. Грузоприемное устройство состоит из грузоприемной платформы (металлической чашки) и держателя платформы. Грузопередающее устройство состоит из направляющих, обеспечивающих вертикальное воздействие на датчик. Индикатор обеспечивает электрическое питание датчика, аналого-цифровое преобразование его сигнала, обработку и индикацию результатов измерений.

Весы лабораторные электронные В выпускают серий ВП и ВТ, к которым относятся модификации: ВПВ-12С ВПВ-22С ВПВ-32С, ВПВ-32.2С, ВПВ-52С – весы с автоматическим устройством юстировки чувствительности встроенным грузом; ВПВ-12, ВПВ-22, ВПВ-32, ВПВ-52, ВПВ-101, ВПТ-12, ВПТ-22, ВПТ-32, ВПТ-52, ВПТ-101, ВПП-12, ВПП-22, ВПП-32, ВПП-52, ВПП-101, ВПС-8/15, ВПС-15/30, ВПС-30/60, ВПС-60/100, ВТ-150, ВТ-150-01, ВТ-300, ВТ-600, ВТ-600-02, ВТ-1500, ВТ-3000 – весы с полуавтоматическим устройством юстировки чувствительности внешней гирей.

Весы выпускаются в двух семействах: семейство 1 объединяет весы серии ВП и ВТ модификаций высокого класса точности, семейство 2 включает весы серии ВП модификаций среднего класса точности.

В весах серии ВП индикатор может крепиться к основанию весоизмерительного устройства, либо может быть расположен рядом с весоизмерительным устройством в удобном месте (исполнение по заказу). В весах серии ВТ индикатор и весоизмерительное устройство находятся в одном корпусе.

Модификации весов различаются максимальной и минимальной нагрузками, действительной ценой деления и габаритными размерами. Кроме того, серии ВП и ВТ различаются типом корпуса. Модификации весов ВТ-150, ВТ-150-01, ВТ-300, ВТ-600 и ВТ-600-02 по заказу оснащаются ветрозащитной витриной.

Весы модификаций ВПС-8/15, ВПС-15/30, ВПС-30/60, ВПС-60/100 позволяют производить измерение массы в одном из выбираемых диапазонов взвешивания (Д1 или Д2).

Весы оснащены следующими устройствами (указанными ниже в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-2011):

- устройством первоначальной установки нуля (Т.2.7.2.4);
- полуавтоматическим устройством установки нуля (Т.2.7.2.2);
- устройством слежения за нулем (Т.2.7.3);
- устройством выборки массы тары (Т.2.7.4);
- автоматическим (весы модификаций ВПВ-ххС) и полуавтоматическим устройством юстировки чувствительности (ВТ, ВПВ-хх, ВПТ, ВПП и ВПС) (4.1.2.5);
- несбрасываемым счетчиком для весов с полуавтоматическим устройством юстировки чувствительности (4.1.2.4);
- устройством установки весов по уровню (Т.2.7.1);
- вспомогательным показывающим устройством (весы модификаций ВПВ) (3.4);
- показывающим устройством с расширением (для весов модификаций ВПТ, ВПП, ВПС и ВТ возможно получение показаний с действительной ценой деления шкалы  $d_1 = 0,1e$  или  $d_1 = 0,2e$  по ручной команде в течение 5 секунд) (4.4.3).

Весы реализуют следующие функции:

- переключения единиц измерения массы;
- подсчета количества штук (деталей);
- взвешивания в процентах;
- вывода данных о юстировке;
- выбора языка сообщений на дисплее (русский, английский) для весов с версией программного обеспечения (ПО) 3.74 и выше;
- подсветки дисплея;
- автовыключания.

Для весов ВП дополнительно функции:

- рецептурного взвешивания (масса нетто/брутто);
- суммирования (последовательное взвешивание образцов и вывод общего веса);
- компарирования (оценка соответствия массы образца установленным значениям);
- определения массы нестабильных образцов (усреднение).

Электропитание весов осуществляется от сети переменного тока через блок питания (адаптер). Возможна работа весов (кроме модификаций ВПВ-ххС) от автономного источника питания (аккумуляторной батареи).

Весы снабжены защищенными интерфейсами USB и RS-232C.



Весы серии ВП



Весы серии ВТ

Рисунок 1 – Общий вид весов

Для защиты весов от несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений, весы пломбируются контрольной этикеткой изготовителя: весы ВТ – по стыку кожуха с основанием; весы ВП – поверх крепежного винта на подставке весоизмерительного блока и по стыку корпуса и днища электронного блока. Схема пломбирования приведена на рисунке 2.

Весы с полуавтоматическим устройством юстировки чувствительности внешней гирей снабжены программным четырехразрядным несбрасываемым счетчиком, показания которого увеличиваются на единицу при каждой юстировке. Для проверки показаний счетчика юстировок следует нажать и удерживать клавишу ТАРА до появления сообщения «Т/С ХХ.Х». Вслед за этим (по истечении 3 с) весы покажут количество проведенных юстировок (например, «N/K. 4») и перейдут в режим взвешивания.

Если показание счетчика не совпадет с зафиксированным при поверке, значит весы не предъявлялись после юстировки внешней гирей в поверку и не могут быть использованы в сфере государственного технического регулирования. Показание счетчика при поверке заносят в раздел «Заключение о поверке» Руководства по эксплуатации (объединенный эксплуатационный документ, включающий паспорт).

Серийный номер и буквенно-цифровое обозначение модификации приведено на маркировочной табличке в виде наклейки, расположенной на задней стенке основания весов. Пример маркировки приведен на рисунке 3.



Рисунок 2 - Схема пломбирования от несанкционированного доступа



Рисунок 3 – Пример маркировки весов

#### Программное обеспечение

В весах используется встроенное программное обеспечение (ПО), выполняющее функции по сбору, передаче, обработке и представлению измерительной информации.

Идентификация программы осуществляется путем просмотра номера версии программного обеспечения на дисплее во время тестирования при включении весов.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует высокому уровню по Р 50.2.077 – 2014 для весов со встроенным устройством юстировки чувствительности и среднему уровню для весов с устройством юстировки чувствительности внешней гирей.

Влияние ПО учтено при нормировании метрологических характеристик.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение для серий	
	ВП	ВТ
Идентификационное наименование ПО	ПО весов ВП	ПО весов ВТ
Номер версии (идентификационный номер ПО)	2.7 - 3.74 и выше	3.74 и выше
Цифровой идентификатор ПО	0xF73E	
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC16	

## Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики в зависимости от модификации					
	ВПВ-12С ВПВ-12	ВПВ-22С ВПВ-22	ВПВ-32С ВПВ-32	ВПВ- 32.2С	ВПВ-52С ВПВ-52	ВПВ- 101
Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011	II (высокий)					
Максимальная нагрузка, Max, кг	12	22	32	32,2	52	101
Минимальная нагрузка, Min, г	5					
Действительная цена деления, d, г	0,1					
Поверочный интервал, e, г	1,0					
Число поверочных интервалов, n	12000	22000	32000	32200	5200	10100
Пределы допускаемой абсолютной погрешности весов, mpe, при поверке, г, в интервалах взвешивания:						
от 5 г до 5 кг включ.	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	-	-
св. 5 кг до 12 кг включ.	±1,0	-	-	-	-	-
св. 5 кг до 20 кг включ.	-	±1,0	±1,0	±1,0	-	-
св. 20 кг до 22 кг включ.	-	±1,5	-	-	-	-
св. 20 кг до 32 кг включ.	-	-	±1,5	-	-	-
св. 20 кг до 32,2 кг включ.	-	-	-	±1,5	-	-
от 50 г до 50 кг включ.	-	-	-	-	±5	±5
св. 50 кг до 52 кг включ.	-	-	-	-	±10	-
св. 50 кг до 101 кг включ.	-	-	-	-	-	±10
Повторяемость (размах) показаний при поверке, не более	mpe					
Диапазон устройства выборки массы тары	от 0 до Max					
Диапазон установки на ноль (суммарный) устройств установки нуля и слежения за нулем, не более	4 % от Max					
Диапазон устройства первоначальной установки нуля, не более	20 % от Max					

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики для модификаций				
	ВПТ-12	ВПТ-22	ВПТ-32	ВПТ-52	ВПТ-101
Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011	(II) (высокий)				
Максимальная нагрузка, Max, кг	12	22	32	52	101
Минимальная нагрузка, Min, г		50		500	
Действительная цена деления, d, г		1		10	
Поверочный интервал, e, г		1		10	
Число поверочных интервалов, n	12000	22000	32000	5200	10100
Пределы допускаемой абсолютной погрешности весов, тре, при поверке, г, в интервалах взвешивания:					
от 50 г до 5 кг включ.	±0,5	±0,5	±0,5	-	-
св. 5 кг до 12 кг включ.	±1,0	-	-	-	-
св. 5 кг до 20 кг включ.	-	±1,0	±1,0	-	-
св. 20 кг до 22 кг включ.	-	±1,5	-	-	-
св. 20 кг до 32 кг включ.	-	-	±1,5	-	-
от 500 г до 50 кг включ.	-	-	-	±5	±5
св. 50 кг до 52 кг включ.	-	-	-	±10	-
св. 50 кг до 101 кг включ.	-	-	-	-	±10
Повторяемость (размах) показаний при поверке, г, не более	mpe				
Диапазон выборки массы тары	от 0 до Max				
Диапазон установки на ноль (суммарный) устройств установки нуля и слежения за нулем, не более	4 % от Max				
Диапазон устройства первоначальной установки нуля, не более	20 % от Max				

Таблица 4 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики для модификаций				
	ВПП-12	ВПП-22	ВПП-32	ВПП-52	ВПП-101
Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011	II (высокий)				
Максимальная нагрузка, Max, кг	12	22	32	52	101
Минимальная нагрузка, Min, г		10			100
Действительная цена деления, d, г	0,2/0,5			2/5	
Поверочный интервал, e, г	1			10	
Число поверочных интервалов, n	12000	22000	32000	5200	10100
Пределы допускаемой абсолютной погрешности весов, тре, при поверке, г, в интервалах взвешивания:					
от 10 г до 5 кг включ.	±0,5	±0,5	±0,5	-	-
св. 5 кг до 12 кг включ.	±1,0	-	-	-	-
св. 5 кг до 20 кг включ.	-	±1,0	±1,0	-	-
св. 20 кг до 22 кг включ.	-	±1,5	-	-	-
св. 20 кг до 32 кг включ.	-	-	±1,5	-	-
от 100 г до 50 кг включ.	-	-	-	±5	±5
св. 50 кг до 52 кг включ.	-	-	-	±10	-
св. 50 кг до 101 кг включ.	-	-	-	-	±10
Повторяемость (размах) показаний при поверке, г, не более	mpe				
Диапазон выборки массы тары	от 0 до Max				
Диапазон установки на ноль (суммарный) устройств установки нуля и слежения за нулем, не более	4 % от Max				
Диапазон устройства первоначальной установки нуля, не более	20 % от Max				

Таблица 5– Метрологические характеристики

Таблица 6 – Метрологические характеристики

Таблица 7 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Потребляемая мощность, В·А, не более	
- весов ВПВ-ххС	9,0
- весов ВПВ-хх, ВПТ, ВПП, ВПС, ВТ	5,0
Время установления рабочего режима, мин, не более	
- весов ВПВ-ххС, ВПВ-хх, ВПТ, ВПП, ВТ	30
- весов ВПС	1
Параметры электрического питания:	
1) сетевое через адаптер:	
- напряжение переменного тока, В	230±23
- частота переменного тока, Гц	50±1
2) автономное от аккумуляторной батареи (кроме весов ВПВ-ххС):	
- напряжение постоянного тока, В, для модификаций ВТ	от 5,0 до 12,0
- напряжение постоянного тока, В, для модификаций ВПВ-хх, ВПТ, ВПП, ВПС	5,0
Условия эксплуатации:	
- предельные значения температуры (Tmin, Tmax), ° С, для модификаций:	
- ВПВ-ххС	+10; +35
- ВПВ-хх, ВПТ, ВПП, ВТ	+15; +30
- ВПС	+5; +35
- относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80
Средний срок службы весов, лет, не менее:	
- для весов ВП	10
- для весов ВТ	8
Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,92

Таблица 8 – Значения массы и размеров весов для различных модификаций

Обозначение модификации	Габаритные размеры чашки весов: длина; ширина или диаметр, мм, не более	Габаритные размеры весов или индикатора и весоизмерительного устройства (длина; ширина; высота), мм, не более	Масса весов, кг, не более
BT-150, BT-150-01, BT-300 BT-600, BT-600-02	120	235; 185; 82 (с установленной витриной высота - 165)	1,0 (1,4)
BT-1500, BT-3000	175; 145	235; 185; 82	1,0
ВПВ-12С		115; 180; 50	14,6
ВПВ-22С, ВПВ-32С, ВПВ-32,2С, ВПВ-52С	350; 320	385; 350; 140	16,5

Продолжение таблицы 8

Обозначение модификации	Габаритные размеры чашки весов: длина; ширина или диаметр, мм, не более	Габаритные размеры весов или индикатора и весоизмерительного устройства (длина; ширина; высота), мм, не более	Масса весов, кг, не более
ВПВ-12, ВПТ-12, ВПП-12			7,4
ВПВ-22, ВПТ-22, ВПП-22			
ВПВ-32, ВПТ-32, ВПП-32			
ВПВ-52, ВПТ-52, ВПП-52			
ВПВ-101, ВПТ-101, ВПП-101			
ВПС-8/15, ВПС-15/30, ВПС-30/60	350; 320	115; 180; 50 385; 350; 125	9,3
ВПС-60/100			

**Знак утверждения типа**

наносится типографским способом на титульный лист Руководства по эксплуатации и на табличку с маркировкой, закрепляемую на корпусе весов.

**Комплектность средства измерений**

Таблица 9 – Комплектность весов лабораторных электронных В

Наименование	Обозначение	Кол-во	Модификация весов
Весы*		1 шт.	Для всех модификаций
Руководство по эксплуатации (объединенный эксплуатационный документ, включающий паспорт)	НПП0.005.013 РЭ	1 экз.	BT-150, BT-150-01, BT-300, BT-600, BT-600-02, BT-1500, BT-3000
	НПП0.005.008 РЭ	1 экз.	ВПВ-12С, ВПВ-22С, ВПВ-32С, ВПВ-32.2С, ВПВ-52С, ВПВ-12, ВПВ-22, ВПВ-32, ВПВ-52, ВПВ-101, ВПТ-12, ВПТ-22, ВПТ-32, ВПТ-52, ВПТ-101, ВПП-12, ВПП-22, ВПП-32, ВПП-52, ВПП-101, ВПС-8/15, ВПС-15/30, ВПС-30/60, ВПС-60/100
Блок питания (адаптер)	-	1 шт.	Для всех модификаций
Чашка	-	1 шт.	BT-150, BT-150-01, BT-300, BT-600, BT-600-02, BT-1500, BT-3000
Держатель чашки	-	1 шт.	BT-150, BT-150-01, BT-300, BT-600, BT-600-02
Амортизатор	-	4 шт.	BT-1500, BT-3000
Витрина**	-	1 шт.	BT-150, BT-150-01, BT-300, BT-600,
Крышка витрины**	-	2 шт.	BT-600-02

Продолжение таблицы 9

Наименование	Обозначение	Кол-во	Модификация весов
Платформа	-	1 шт.	ВПВ-12С, ВПВ-22С, ВПВ-32С, ВПВ-32.2С, ВПВ-52С, ВПВ-12, ВПВ-22, ВПВ-32, ВПВ-52, ВПВ-101, ВПТ-12, ВПТ-22, ВПТ-32, ВПТ-52, ВПТ-101, ВПП-12, ВПП-22, ВПП-32, ВПП-52, ВПП-101, ВПС-8/15, ВПС-15/30, ВПС-30/60, ВПС-60/100
Аккумуляторная батарея**		1 шт.	ВТ-150, ВТ-150-01, ВТ-300, ВТ-600, ВТ-600-02, ВТ-1500, ВТ-3000 ВПВ-12, ВПВ-22, ВПВ-32, ВПВ-52, ВПВ-101, ВПТ-12, ВПТ-22, ВПТ-32, ВПТ-52, ВПТ-101, ВПП-12, ВПП-22, ВПП-32, ВПП-52, ВПП-101, ВПС-8/15, ВПС-15/30, ВПС-30/60, ВПС-60/100
Кабель для подключения аккумуляторной батареи**		1 шт.	ВТ-150, ВТ-150-01, ВТ-300, ВТ-600, ВТ-600-02, ВТ-1500, ВТ-3000 ВПВ-12, ВПВ-22, ВПВ-32, ВПВ-52, ВПВ-101, ВПТ-12, ВПТ-22, ВПТ-32, ВПТ-52, ВПТ-101, ВПП-12, ВПП-22, ВПП-32, ВПП-52, ВПП-101, ВПС-8/15, ВПС-15/30, ВПС-30/60, ВПС-60/100

\*- Весы ВП по заказу поставляются с выносным электронным блоком

\*\*-Поставляются по заказу

**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в разделе 3 «Использование весов» Руководства по эксплуатации (объединенный эксплуатационный документ, включающий паспорт) НПП0.005.013 РЭ «Весы лабораторные электронные ВТ. Руководство по эксплуатации» и Руководства по эксплуатации (объединенный эксплуатационный документ, включающий паспорт) НПП0.005.008 РЭ «Весы лабораторные электронные ВП. Руководство по эксплуатации».

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам лабораторным электронным В**

ГОСТ ОИМЛ R 76-1-2011 ГСИ. Весы неавтоматического действия. Часть 1.

Метрологические и технические требования. Испытания

Государственная поверочная схема для средств измерений массы, утвержденная приказом Росстандарта от 29 декабря 2018 г. № 2818

Технические условия ВТНЛ.404314.002 ТУ «Весы лабораторные электронные ВП, ВТ. Технические условия»

**Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Госметр» (ООО «НПП Госметр»)

ИНН 7816517580

Адрес: 19020, Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 58, литер Б, пом.14-Н

Телефон: (812) 578-54-90, телефон (факс): (812) 578-54-30

Web-сайт: [www.gosmetr.ru](http://www.gosmetr.ru)

E-mail: [info@gosmetr.ru](mailto:info@gosmetr.ru)

**Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 19


Телефон: +7 (812) 251-76-01

Факс: +7 (812) 713- 01-14

Web-сайт: [www.vniim.ru](http://www.vniim.ru)

E-mail: [info@vniim.ru](mailto:info@vniim.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.311541

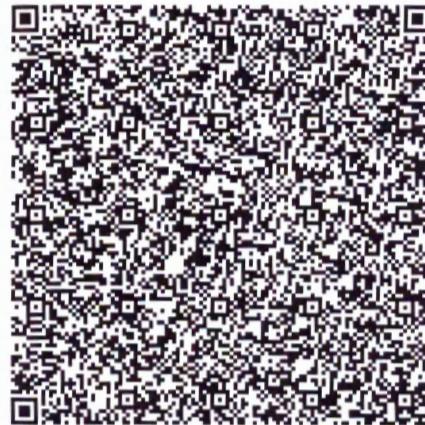

Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федеральное агентство по техническому регулированию и  
метрологии.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 02B52A9200A0ACD583455C454C1E1FAD5E  
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович  
Действителен: с 29.12.2020 до 29.12.2021

А.П.Шалаев

М.п

«26» ноября 2021г.

